

2019年3月7日

お客様各位

株式会社 八光  
メディカル事業部


## スパイナル針 M 型 販売終了のお知らせ

拝啓 時下益々ご隆昌の段、お慶び申し上げます。  
日頃は八光製品に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。  
さて、長い間ご使用を賜りました上記製品につきまして、誠に勝手ながら 2020 年 2 月末をもちまして販売を終了させていただくこととなりました。  
代替品につきましては『スパイナル針 P 型』をご用意しておりますので、ご検討いただきますようお願い申し上げます。  
何卒ご賢察の上ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

### 1 販売終了製品と代替品

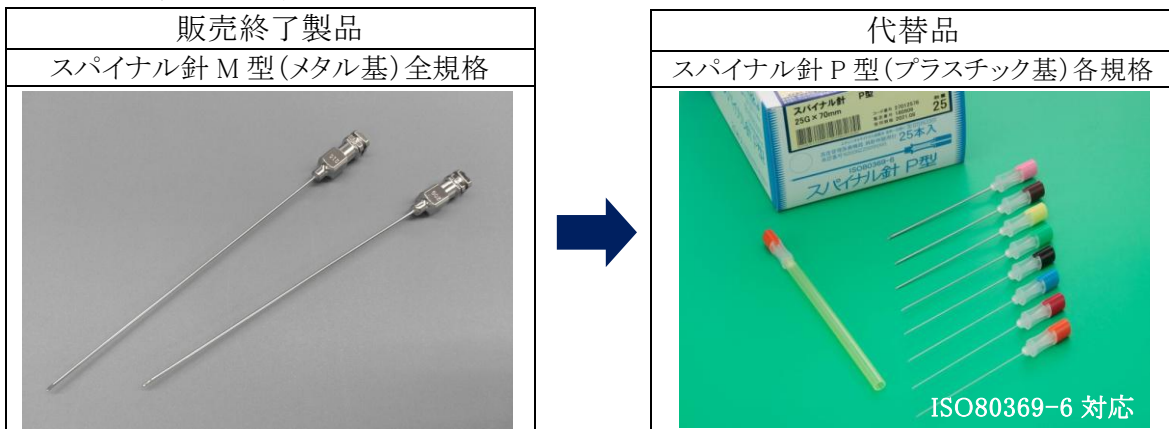

\*代替品の詳細につきましては別途資料をご参照ください。

### 2 販売終了時期

**2020年2月末**

(上記の期日までに ISO80369-6 誤接続防止コネクタ対応製品への切り替えをお願いいたします。)

### 3 販売終了の理由

ISO80369-6 誤接続防止コネクタ対応の金属基での製造を試みましたが、対応する針基の製造が困難であることから、誠に勝手ながら上記期限をもちまして販売を終了させていただくこととなりました。

ご不明な点がございましたら、最寄りの支店・営業所へお問い合わせください。

以上、よろしくお願い申し上げます。